


TANDBERG BÄNDOPPLÄKER TYPE 2

Tandberg
GROBORG

R1-C2, R5-C3 TILPASSES HODENE
FOR JUSTERING AV AVSPILLINGS-
KURVEN VED NENHOLDSVIS 1 7/8"
OG 3 3/4" PR. SEK

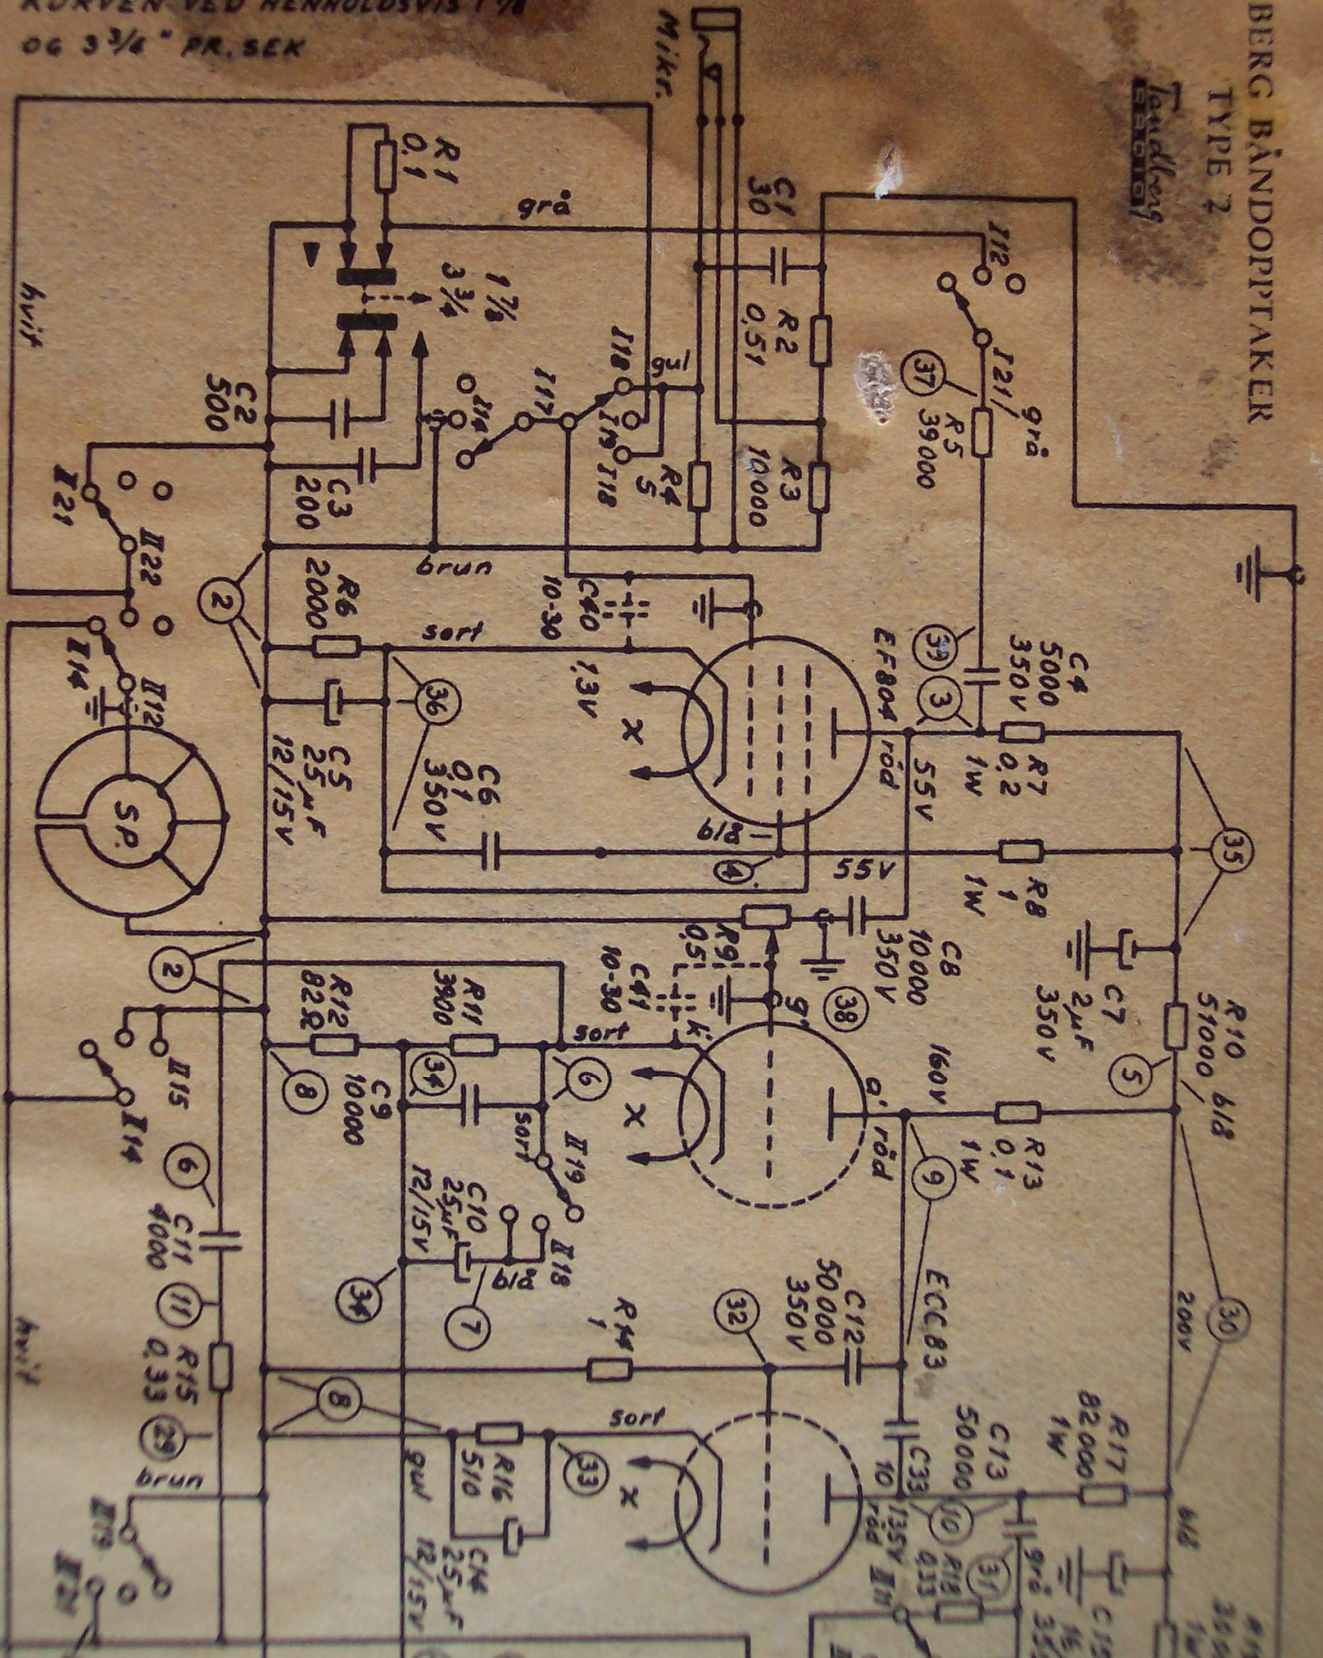



C40 OG C41 KAN SETTES INN
(DIRIKTE PÅ RØRHOLDEREN)
FOR Å REDUSERE UØNSKETE
HØYFREKVENDELYD

INNSIRKLETTALL
TILSVARER DISSE

OPPTAKVENDER DERRE I 2 OG 3
STÅR I STILLING: INN.


R1-C2, R5-63
FOR JUSTERING
KURVEN VED
OG 3 3/4" PR. 30

C90 OG C91 KAN SETTES INN
(DIREKTE PÅ RØRHOLDEREN)
FOR Å REDUSERE ØNDSKETE
HØYFREKVENSSIGNALER
C9 C11 C18 REGULERER
INNSPILINGSKURVEN.

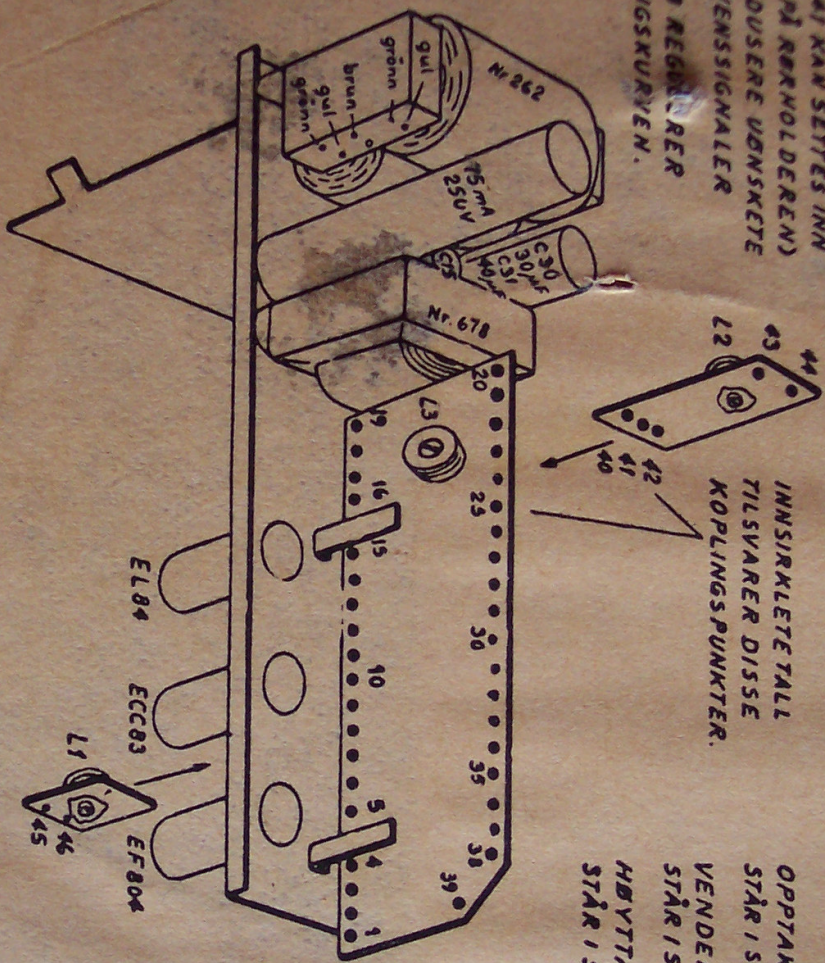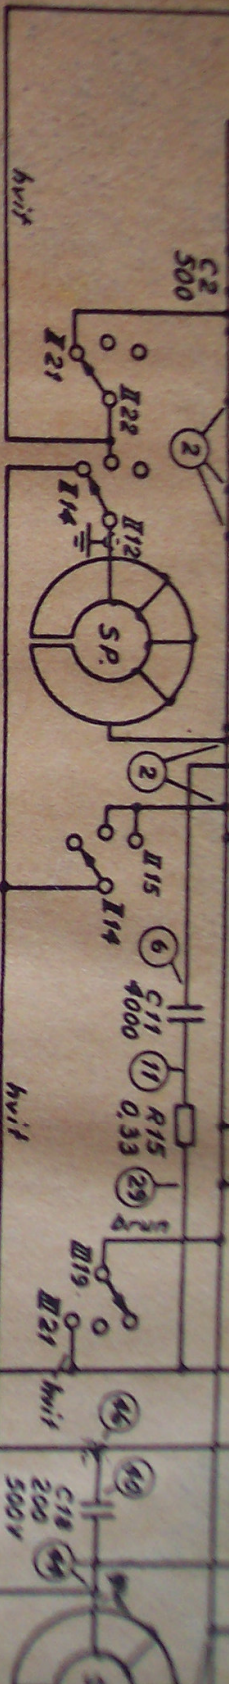


OPPTAKVENDER DEKK I, II OG III
STÅR I STILLING : INN.
VENDER 3 3/4 - 1 7/8
STÅR I STILLING : 3 3/4.
HØYTTALERVENDER
STÅR I STILLING : 1 + 2.



R20 TILPASSES HODENE FOR
JUSTERING AV INNSPILINGS-
STRØMMEN VED FULL SAMMEN-
KLAPPING AV TROLLØYET.
LIKESPENNINGER ER MÅLT
VED AVSPILLING UNDATT
FOR EM71.

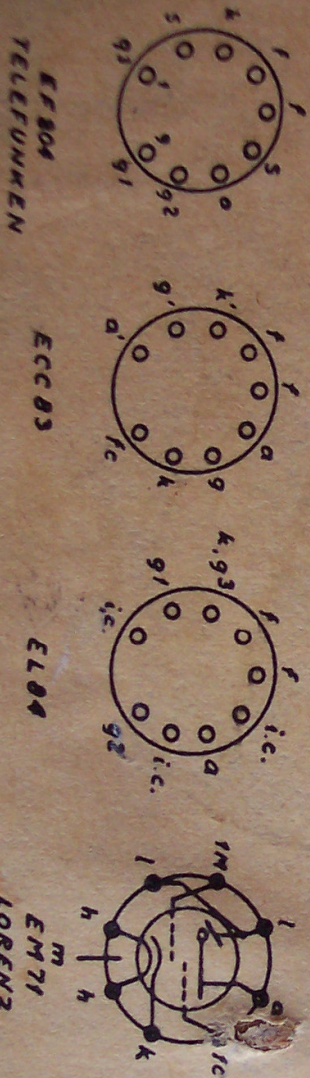

APPARATETS FRONTANSICHT

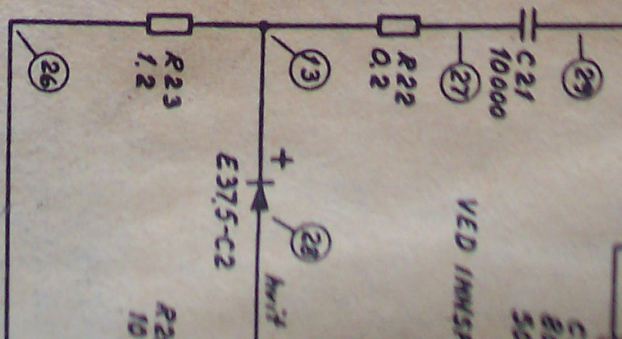

2) TEMPERATURSIKRING, ROSES METALL.

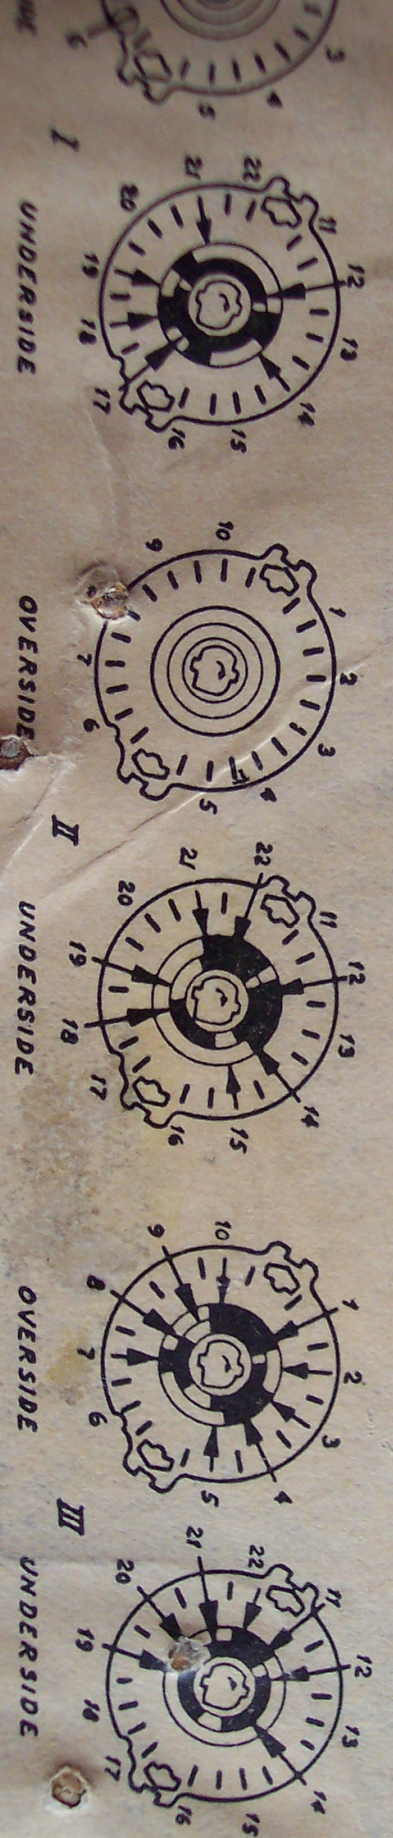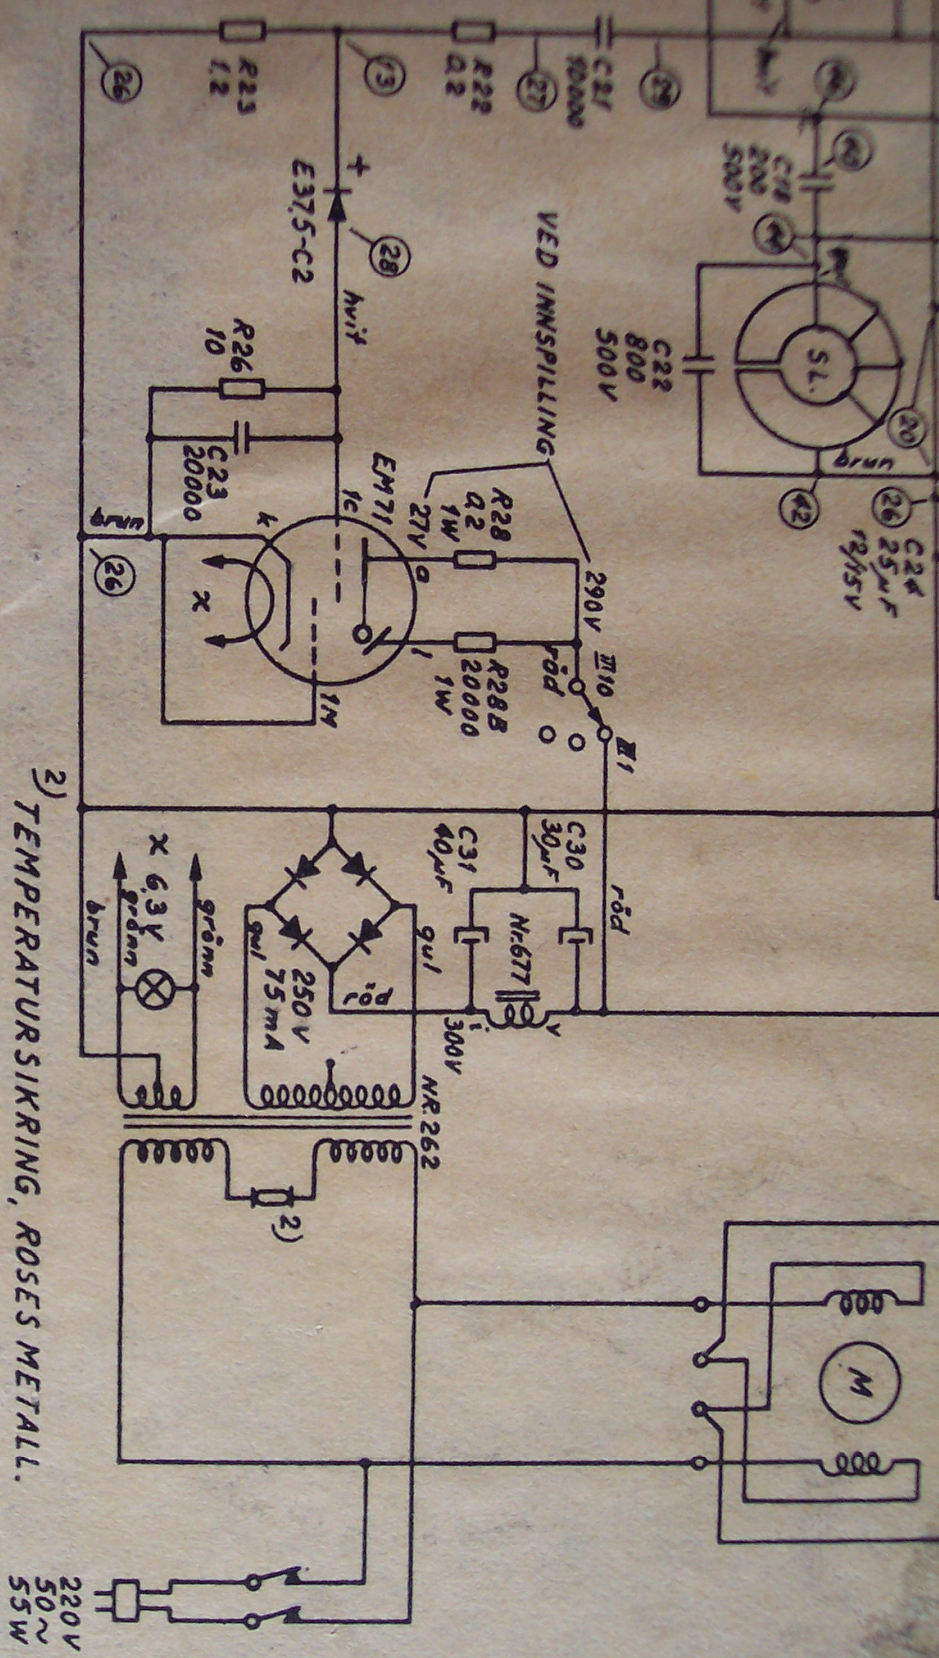

VENDER NR. 1756
SETT FRA KNAPPESIDEN.

TEGN. NR. 1628 C
L.H.

FRASLETS FRONTLINJE